

IL NOSTRO BRAVO LABORATORIO

Via Chiara Clarenza, 1 - 100100 Belrespiro (LU)

CLEARANCE POLMONARE


XXXXXXXX XXXXXXXX - F - 1994/11/04

(PAT_2db693b91ddf58d-vpp4vtzchj_0)

- Sessione SES_2db693b91ddf58d-ynehk9woip_0
 - ◆ Sottosessione RBDIL1 SSE_2db693b91ddf58d-733dv897ml_0

Data e ora di inizio: 2009/12/04 - 12:01:29

◇ Test RBDIL1 TST_2db693b91ddf58d-idnua4lnis_0

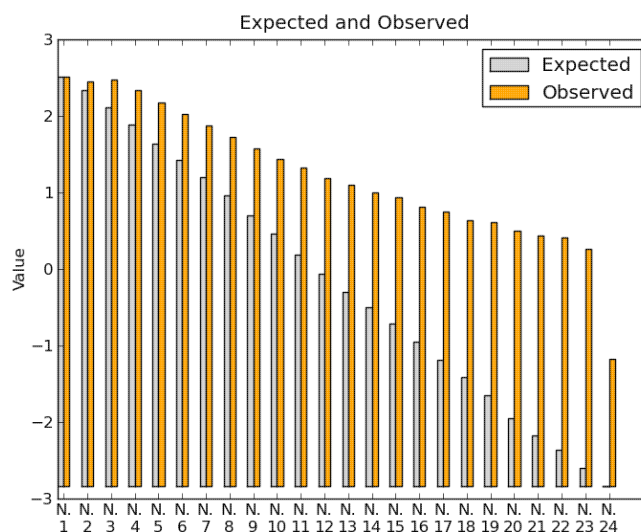

Asse X: respiri.

Asse Y: logaritmo naturale del rapporto di diluizione.

Le barre grige si riferiscono al rapporto di diluizione teorico (Expected), atteso in condizioni di diffusività istantanea; le barre arancioni si riferiscono al rapporto di diluizione osservato (Observed).

Sono riportati i respiri fino alla diluizione al 90% osservata.

Volume Residuo RV (l): **1.14**

Volume Tidale TV (l): **0.75**

Capacità Funzionale Residua FRC (l): **2.28**

Capacità Polmonare Totale TLC (l) in diluizione: **4.58**

Tempo di diluizione al 90% (sec): **45.53**

Numero teorico di respiri per diluizione al 90%: **11**

Numero osservato di respiri per diluizione al 90%: **24**

LCI teorico: **3.16**

LCI osservato: **7.55**

Efficienza (LCI teorico / LCI osservato): **.41**

Approfondimento Diagnostico **Biomedin® B3Box**

<http://www.biomedin.com>